



SÉRGIO CURY

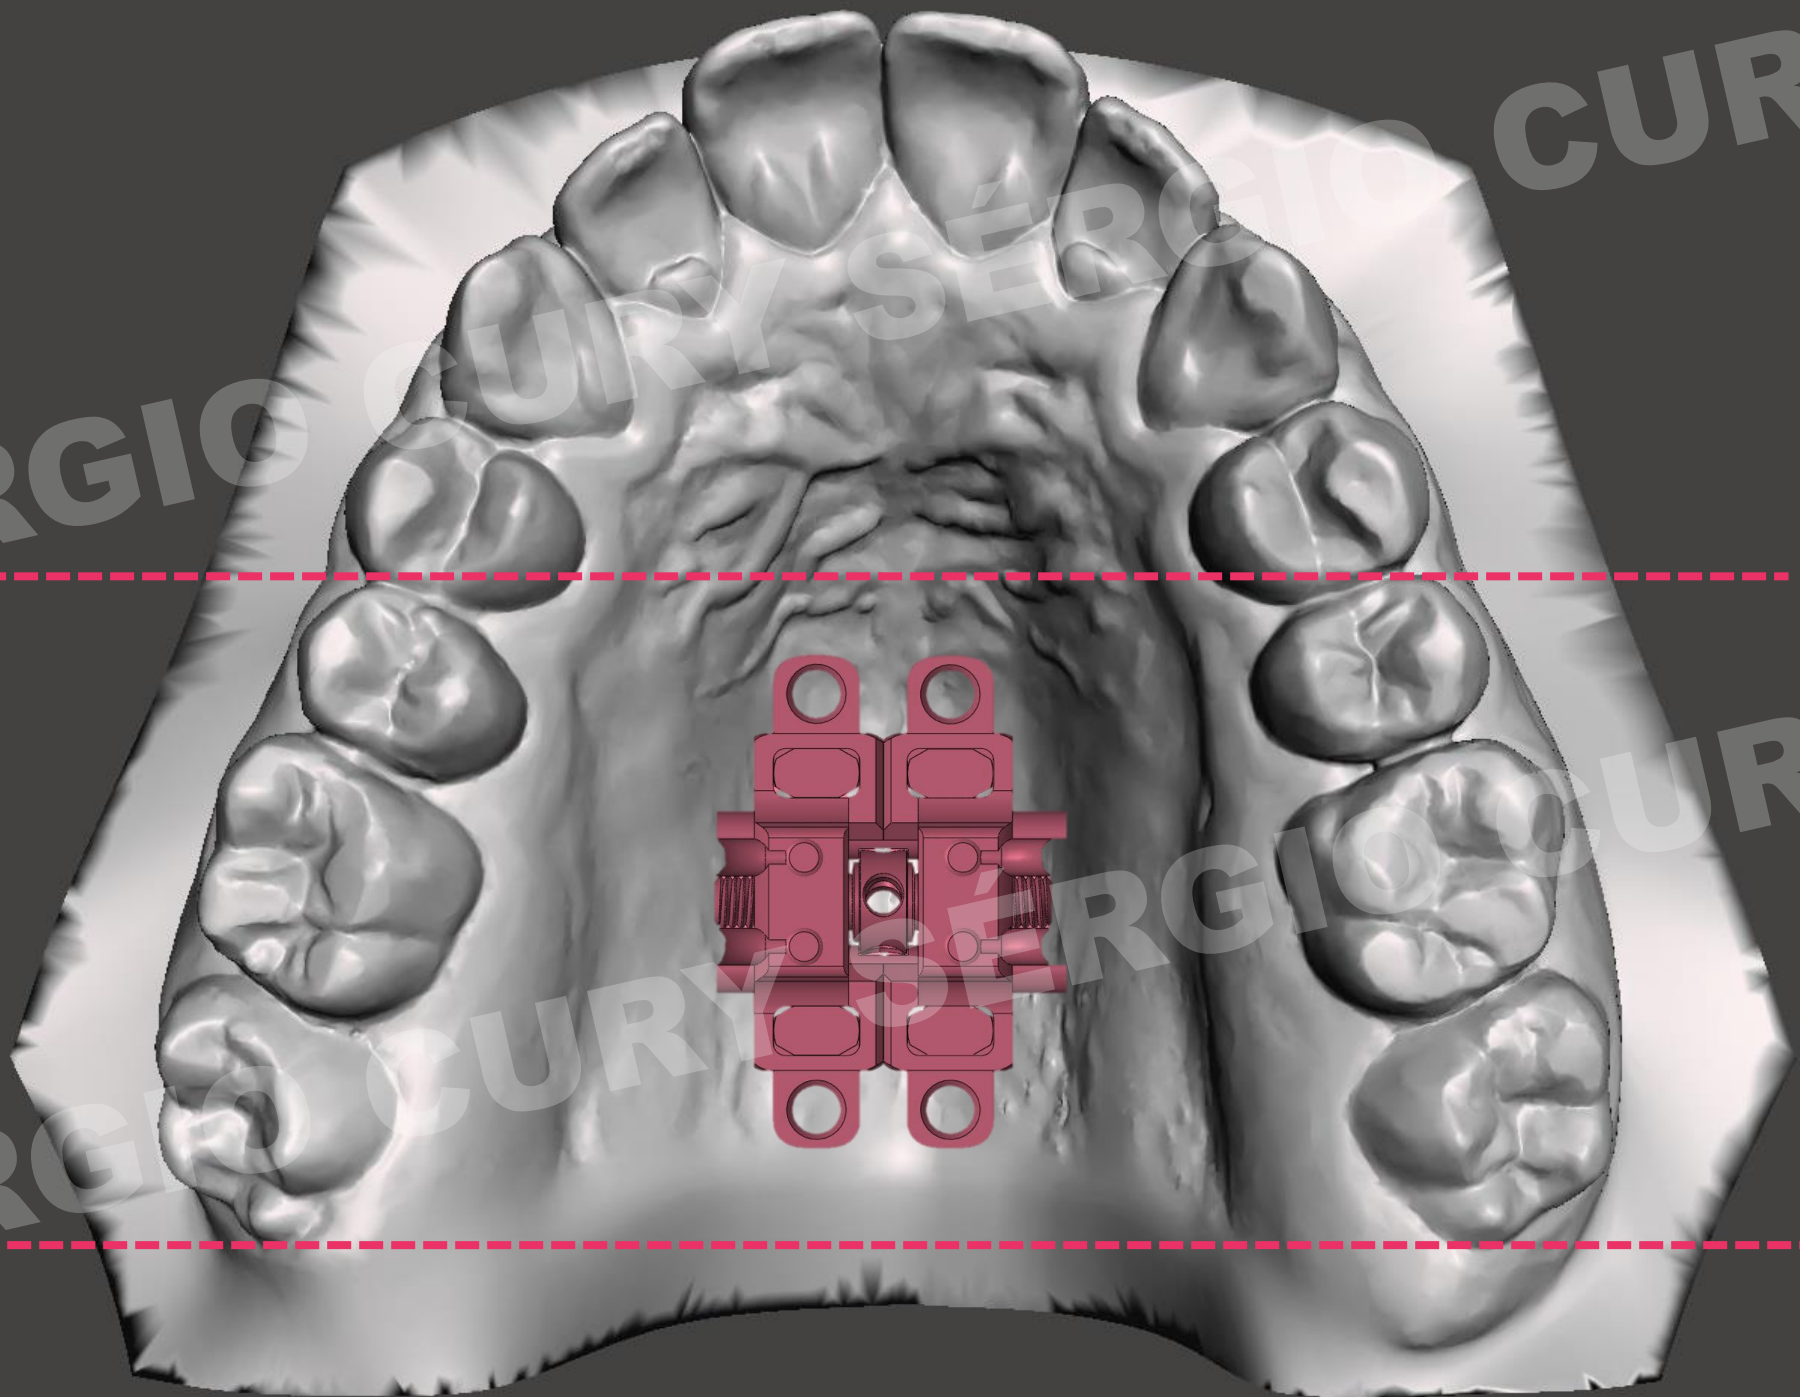

SÉRGIO CURY

Distal 5

Distal 7

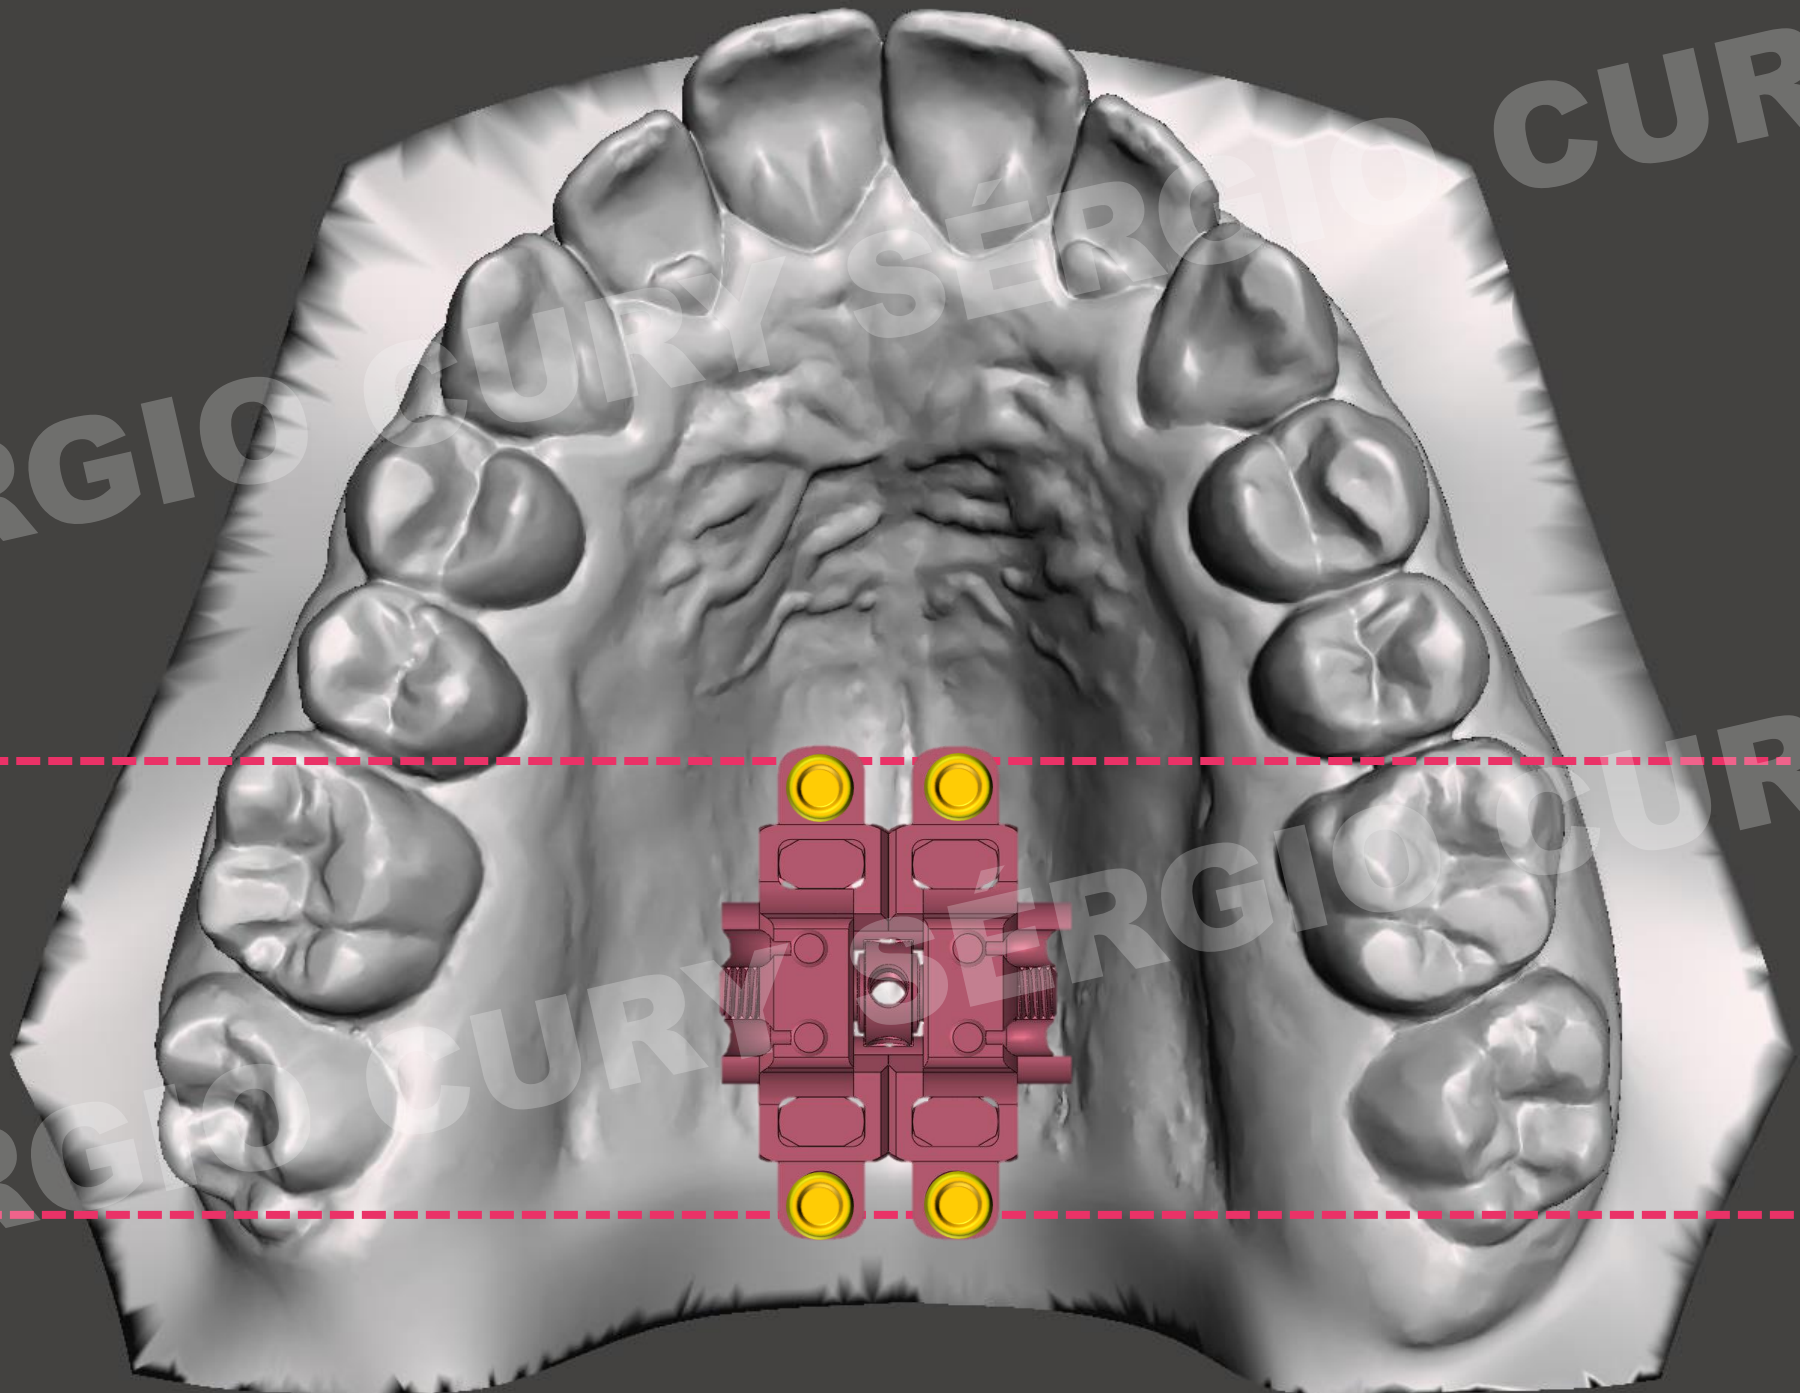


Distal 4

Distal 5

Distal 6

Distal 7

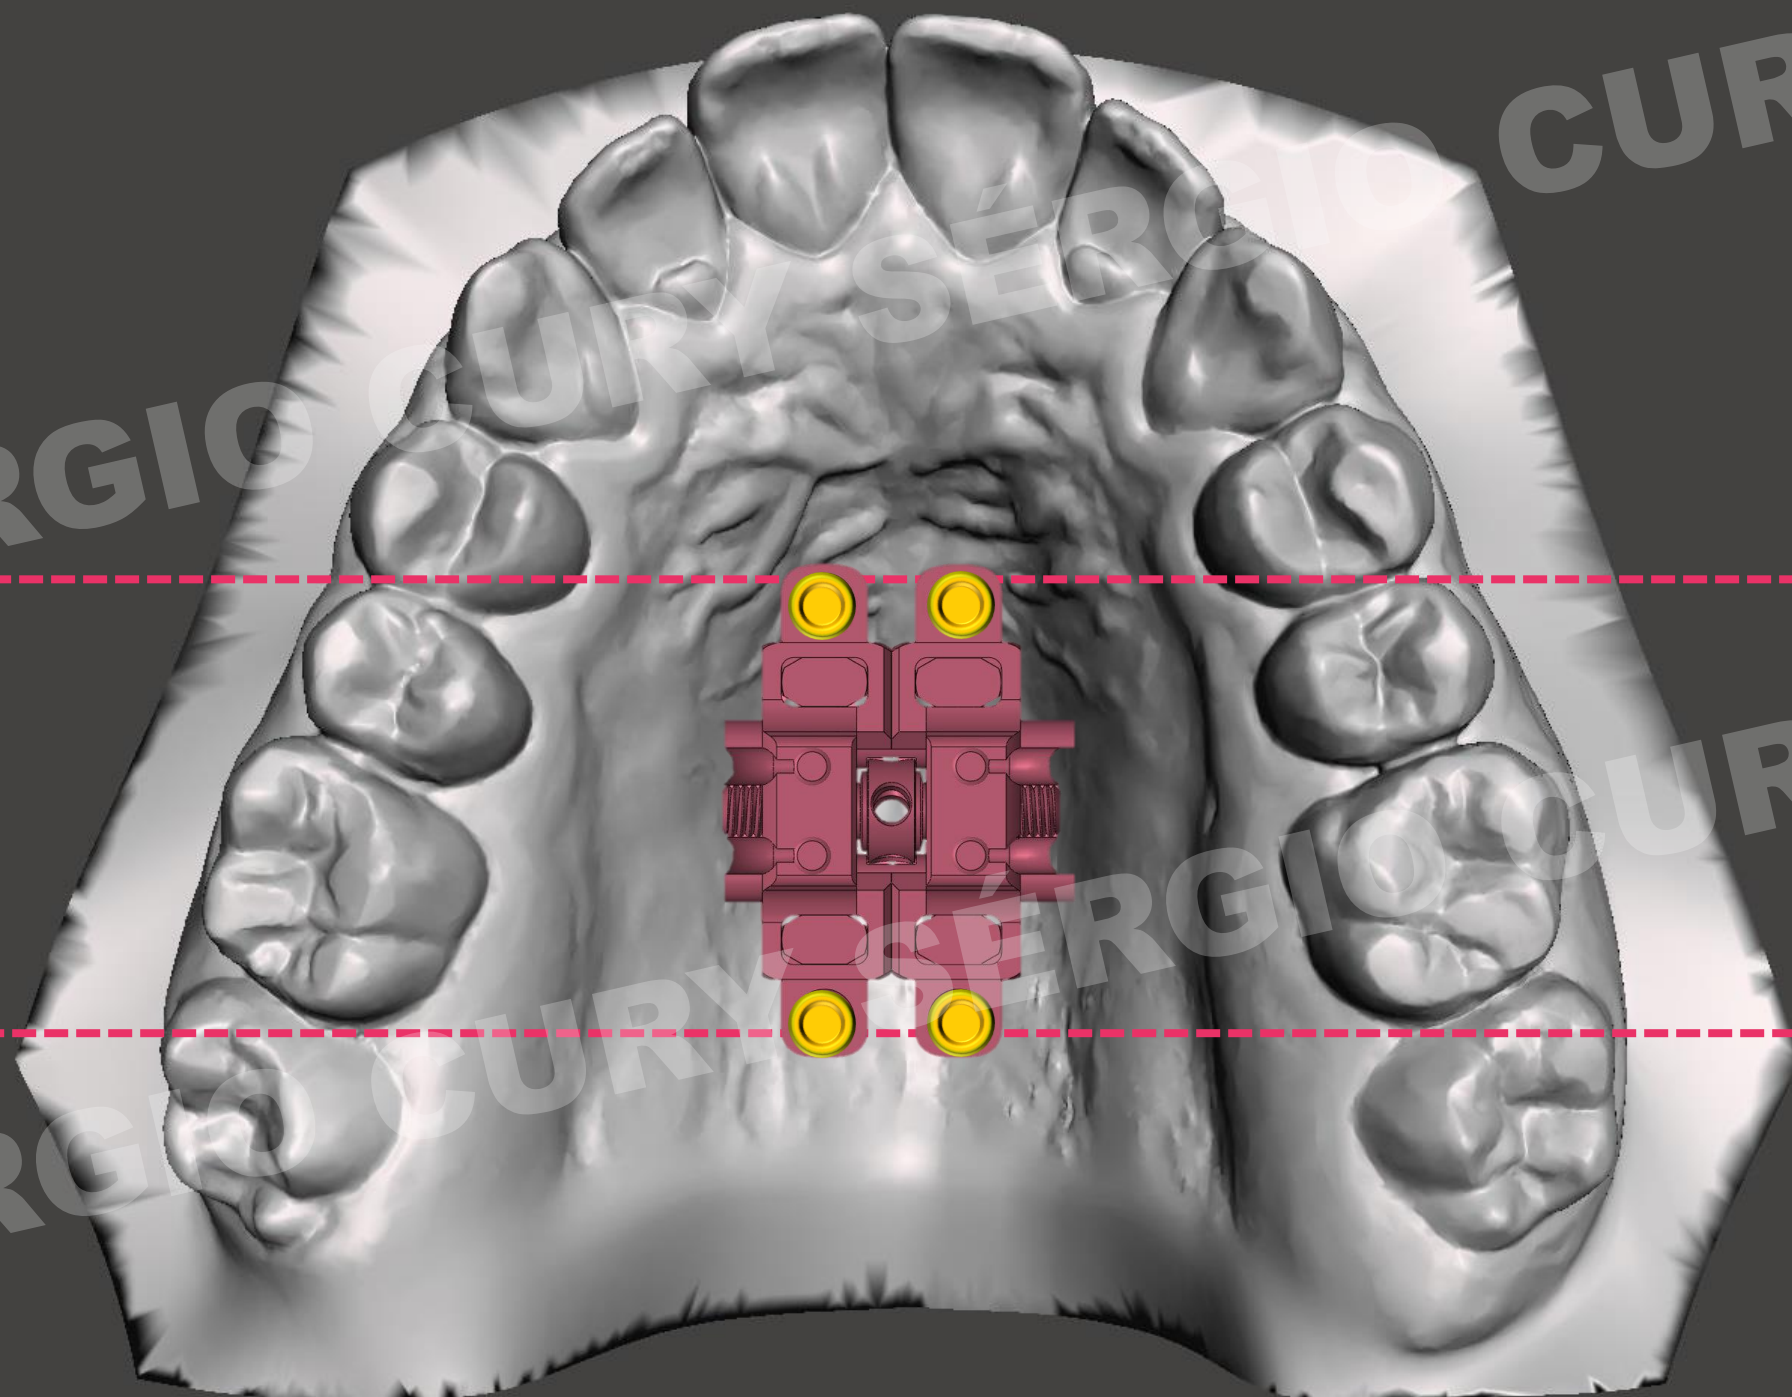


Anterior
Distal 4

Distal 5

Distal 6

Distal 7

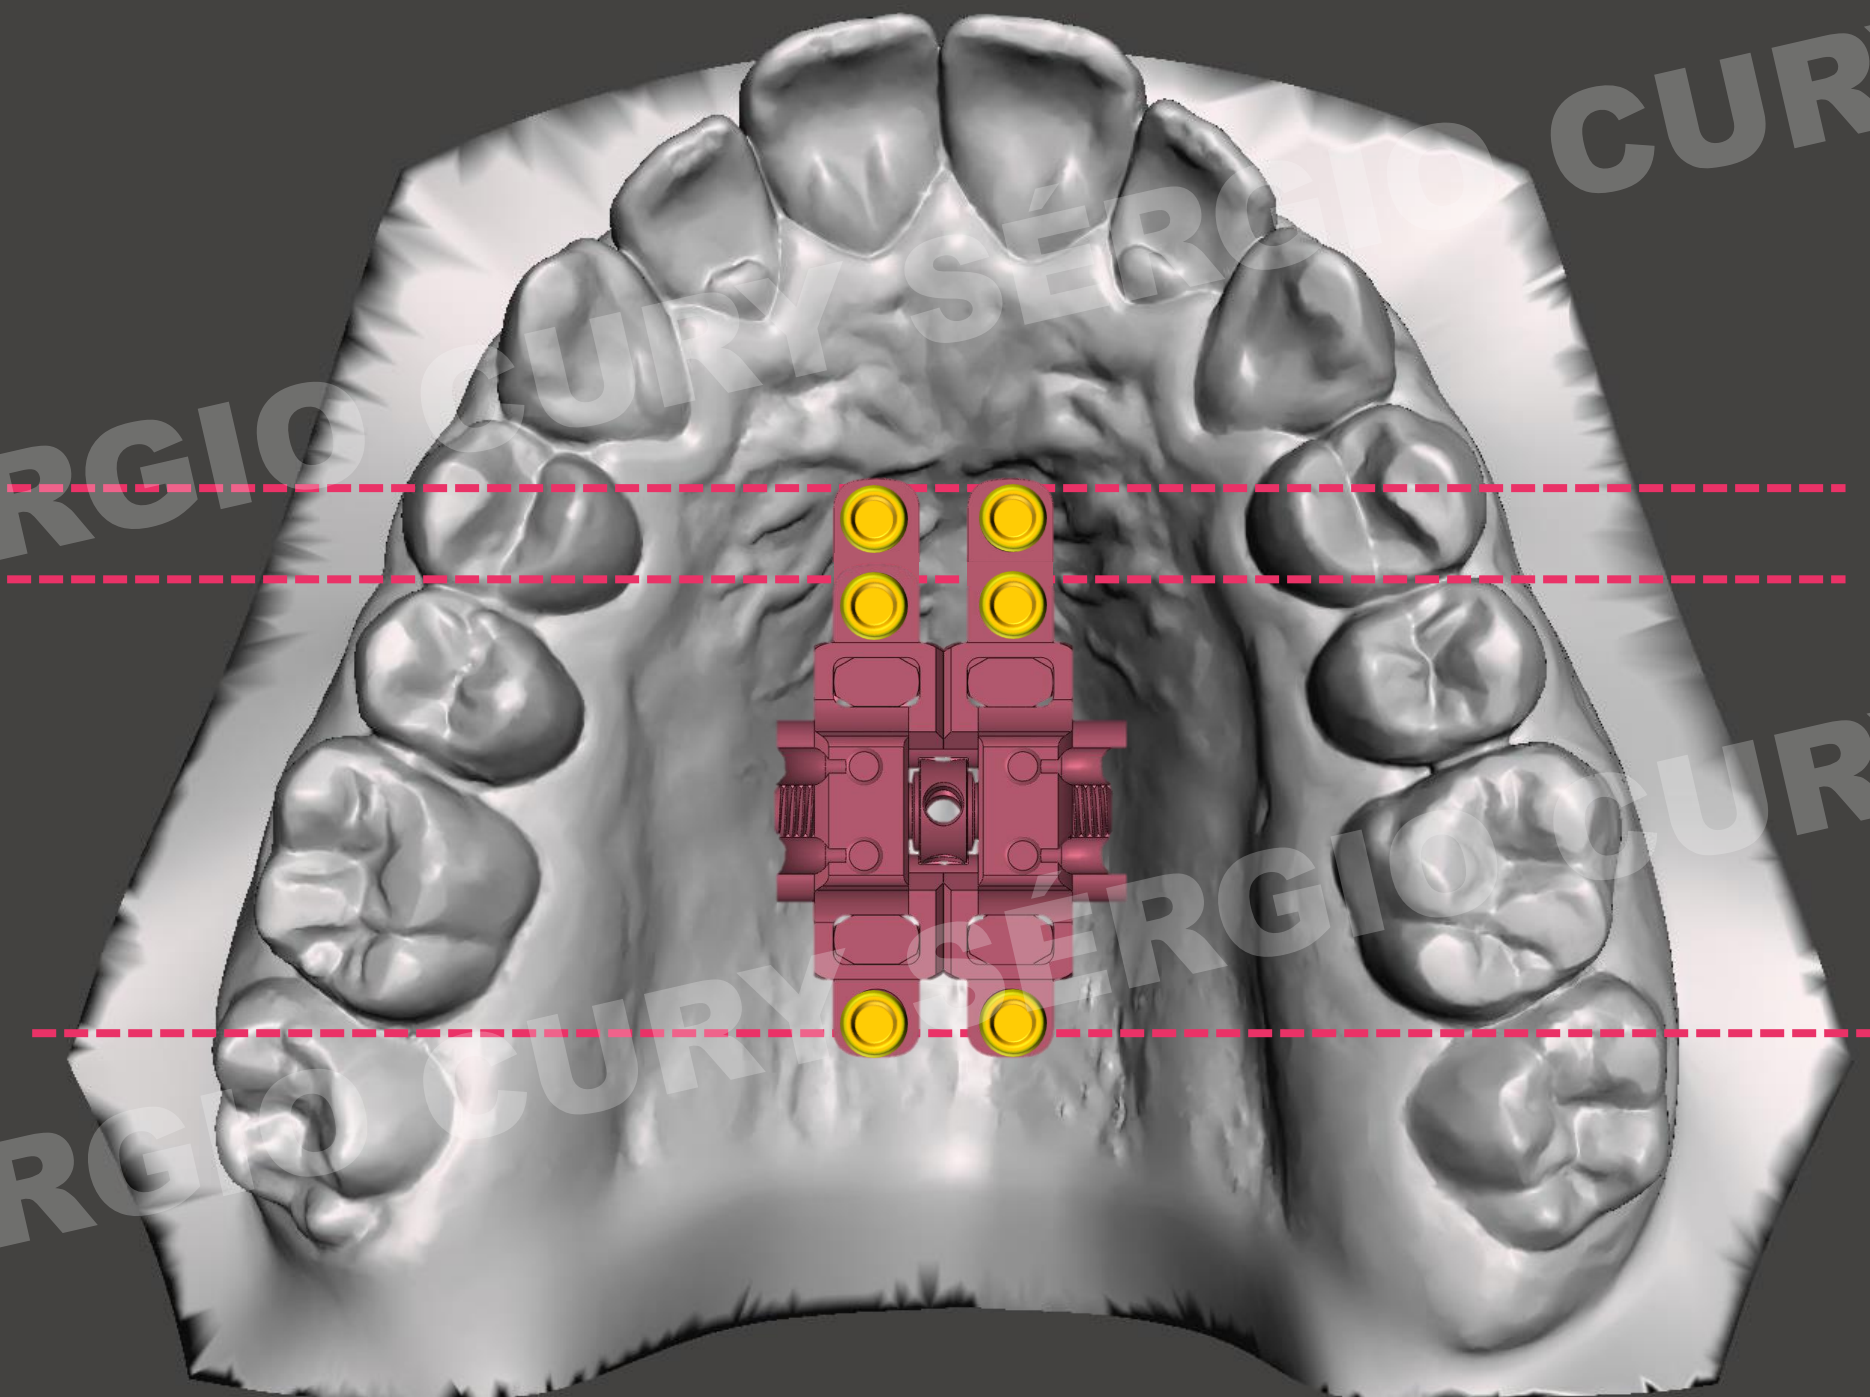

SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY


Anterior

Distal 4

Distal 5

Distal 6

Distal 7

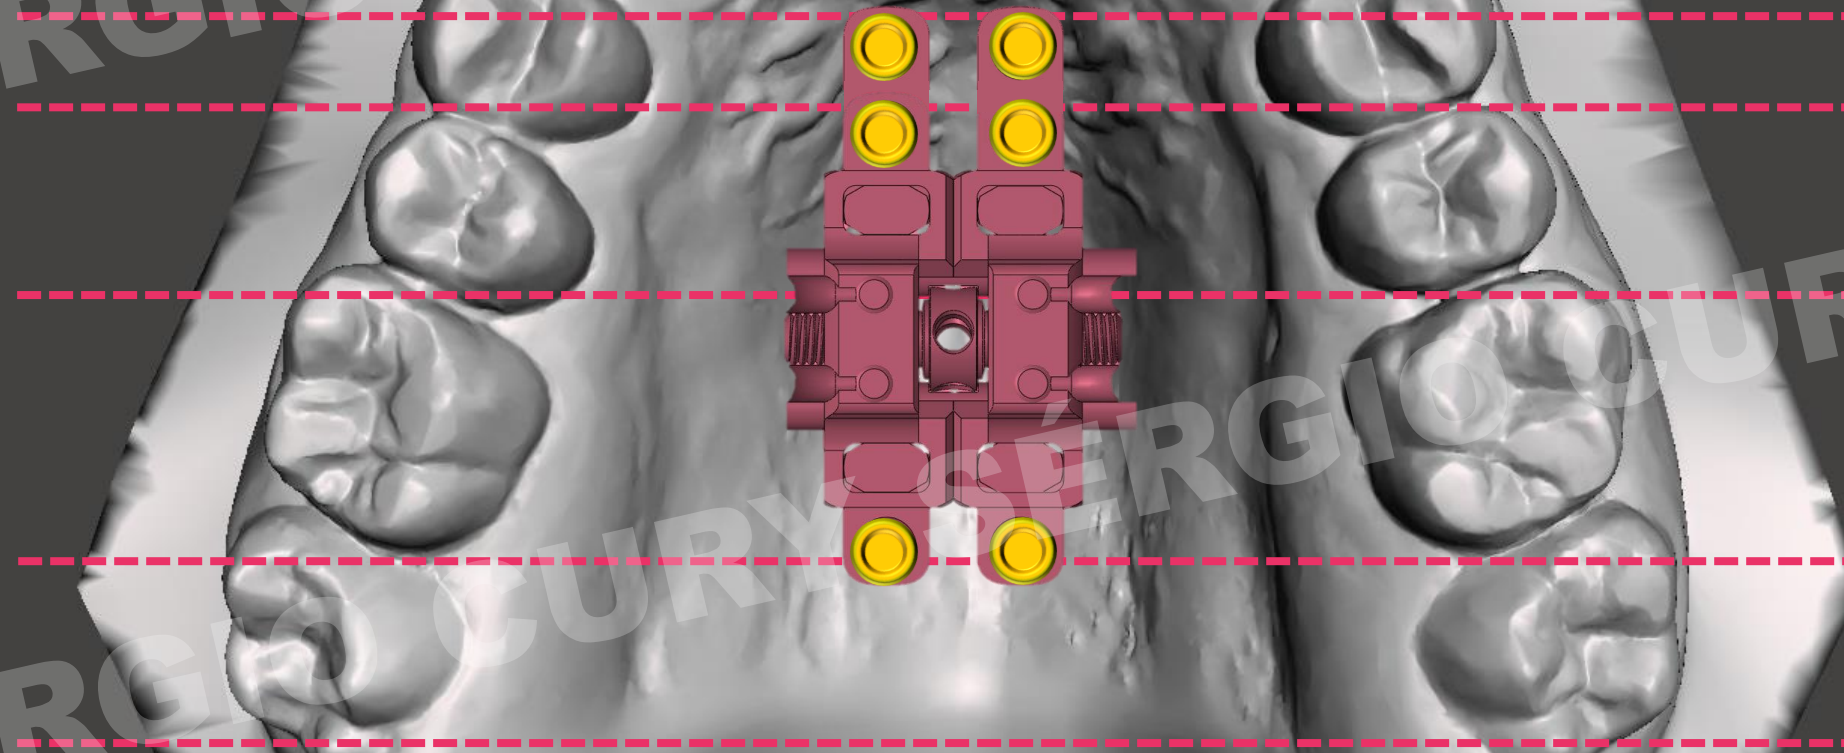

SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY

área 1

área 2


área 3

área 4


anterior

25mm

SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY

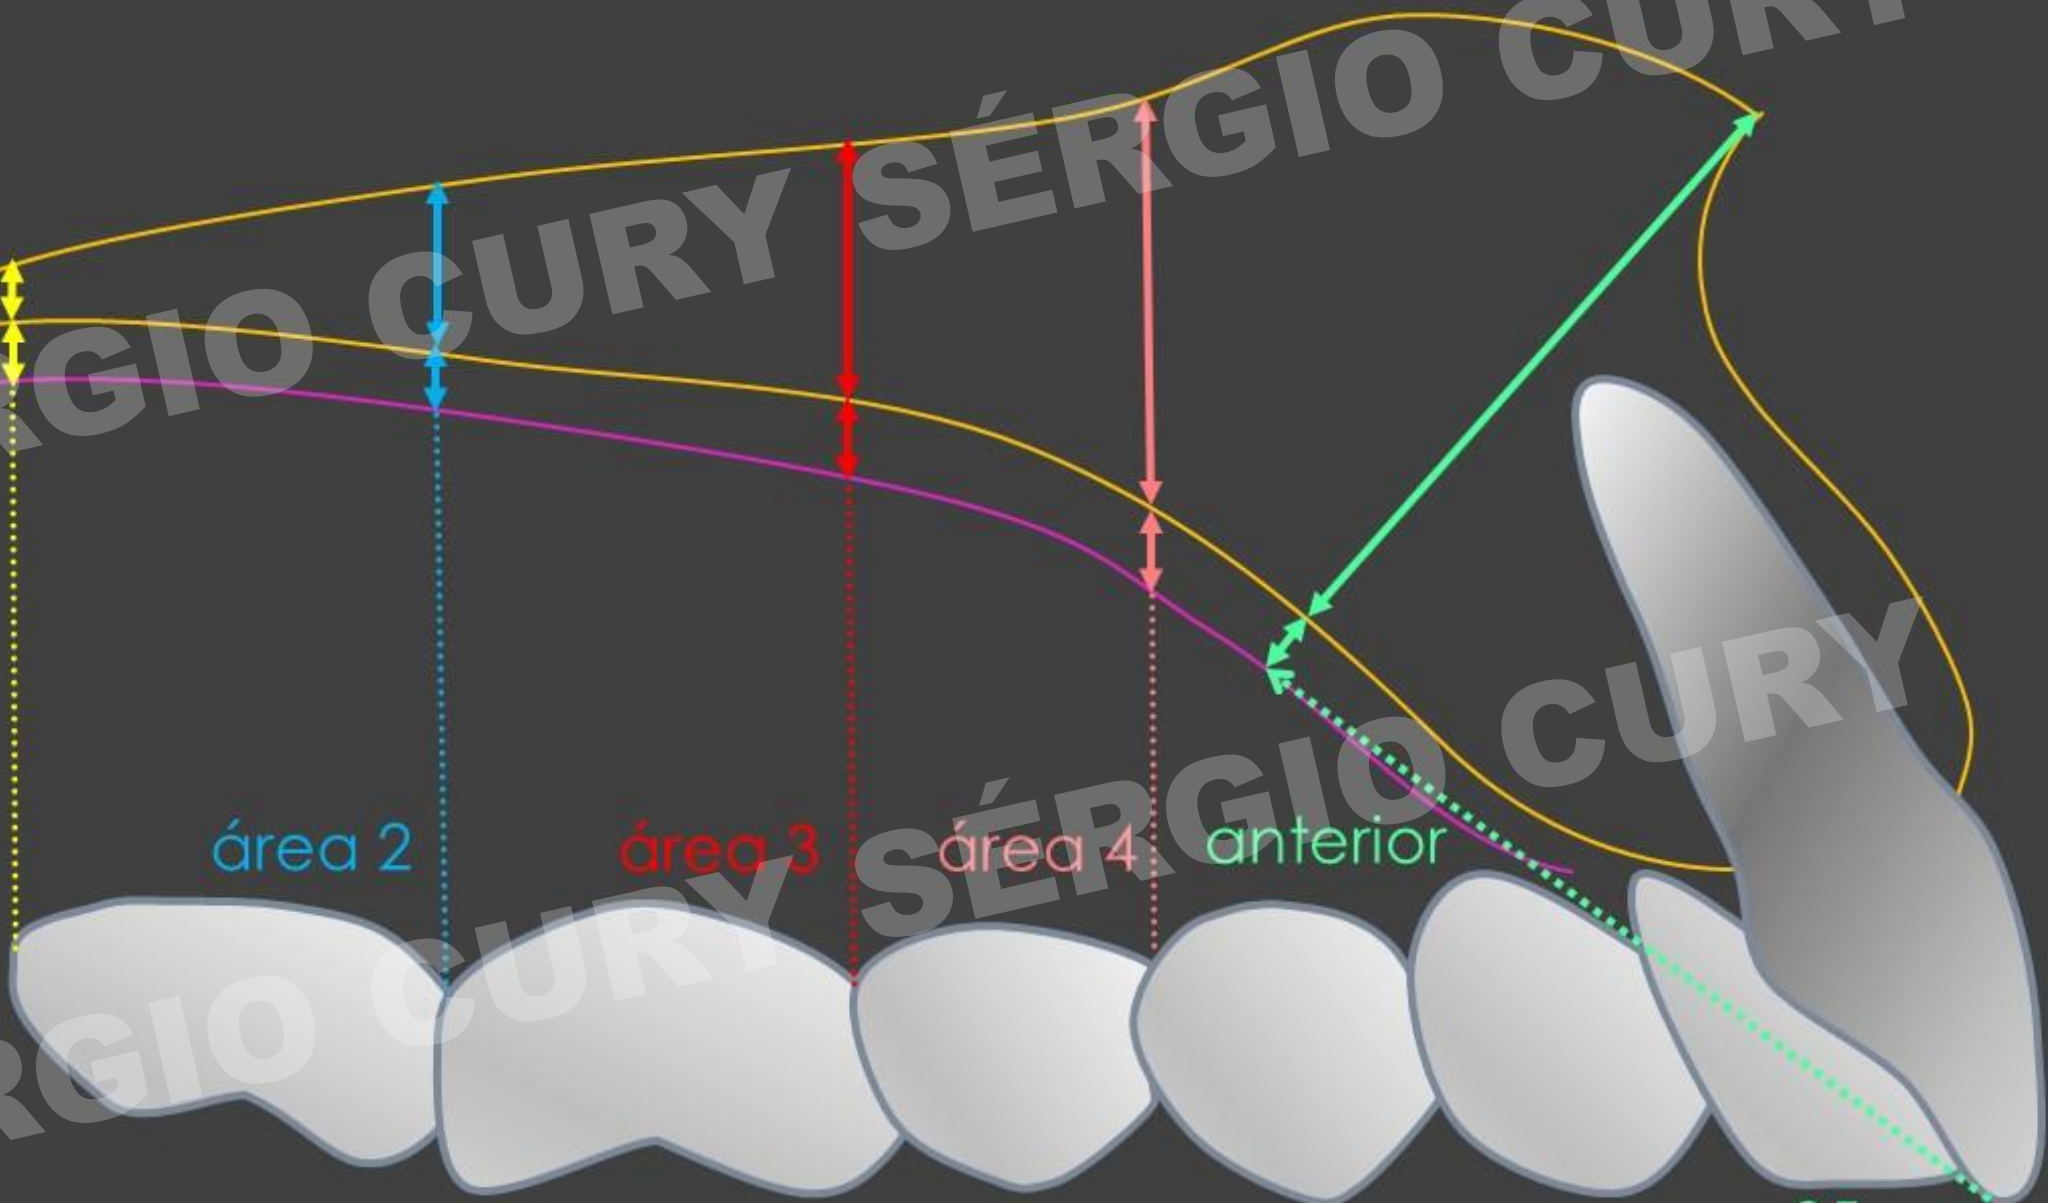

2.5mm lateral à sutura

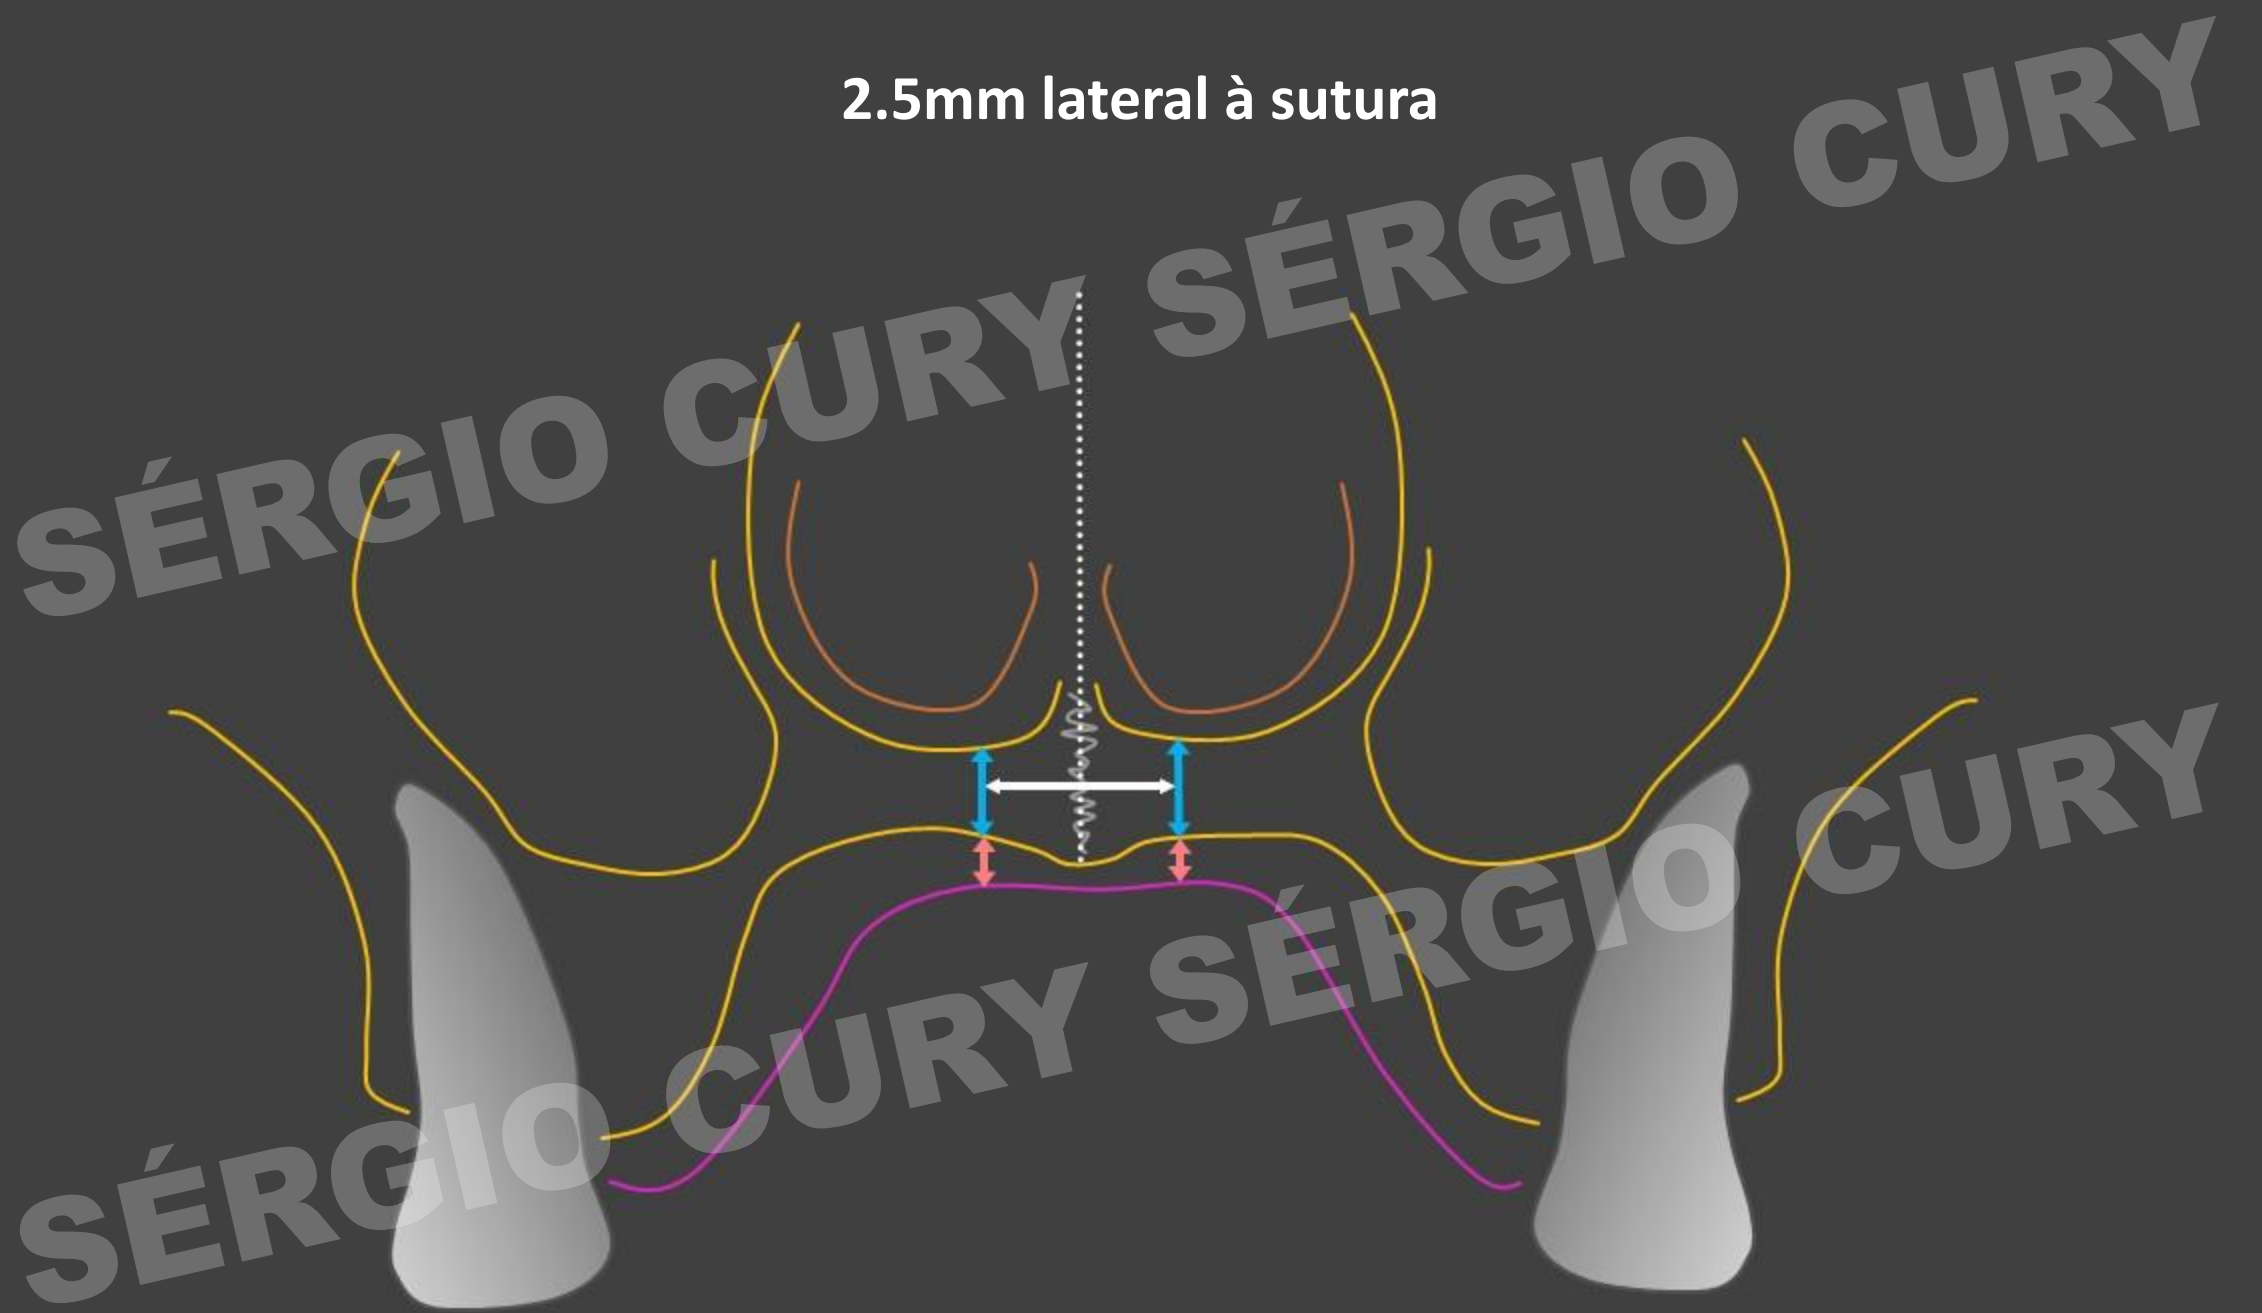


Coronal



Sagittal



Axial

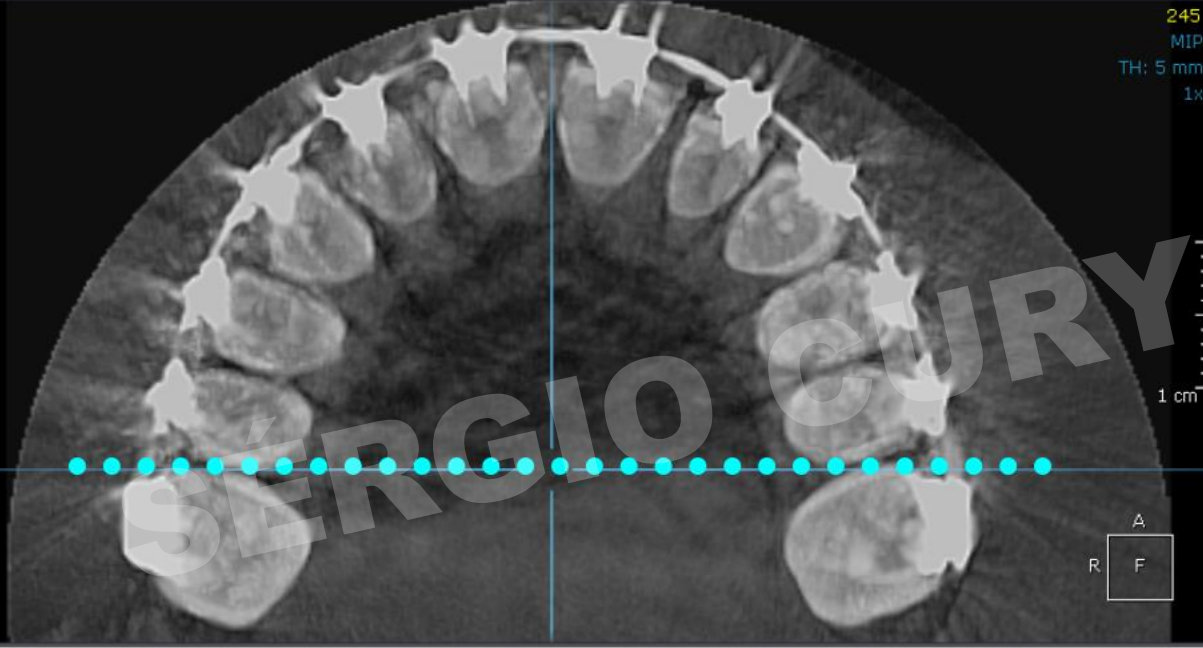

3D




Ajuste fino

Auto WWL Un-shaded Dentes

SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY

6.00


9 mm



SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY

3.80 | 6.00

9 mm



SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY


3.80

6.00


1.30

9 mm


SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY



SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY

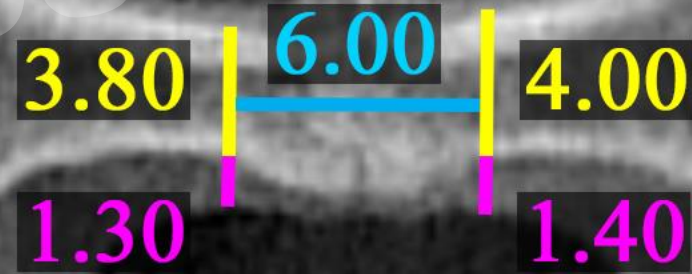

9 mm






4 MM

2 MM
ENCAIXE DA
CABEÇA

2 MM
GUIA DE
INSERÇÃO


SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY

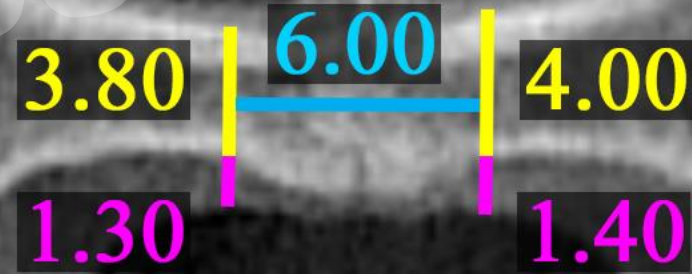

+ 2.20 mm




9 mm




Modelo - Código	Diâmetro A (mm)	Rosca B (mm)	Transmucoso C (mm)
HS MARPE - 3129	1,8	5	4
HS MARPE - 2926	1,8	7	4
HS MARPE - 5574	1,8	7	6
HS MARPE - 5500	1,8	7	8

Penetração cavidade nasal até 2.50mm

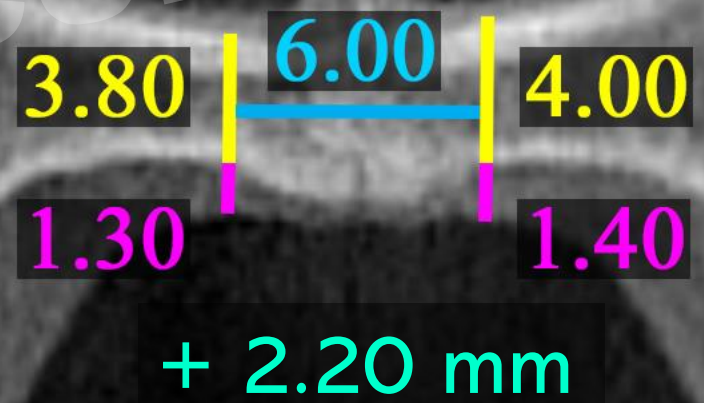


5	4
7	4
7	6
7	8

7.30 7.60



9 mm

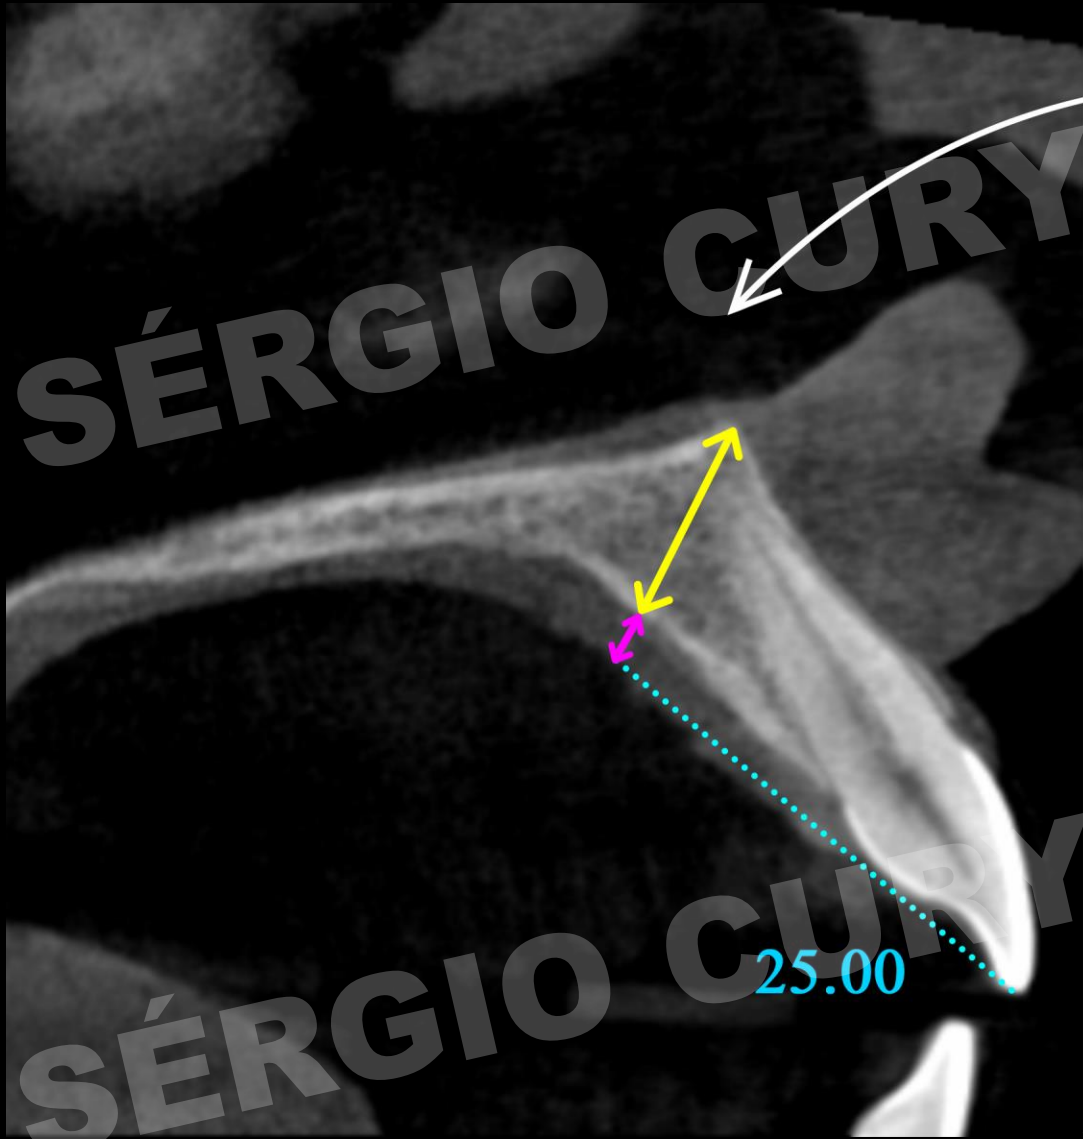

SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY

12.25 mm

2.05 mm

SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY

25.06 mm

